


放射線の量と人体への影響

200mSv 以下では臨床症状は確認されていません。

* 当社の DXA 装置は設置に届出が必要ですが、被ばくによる影響はほとんどありません。

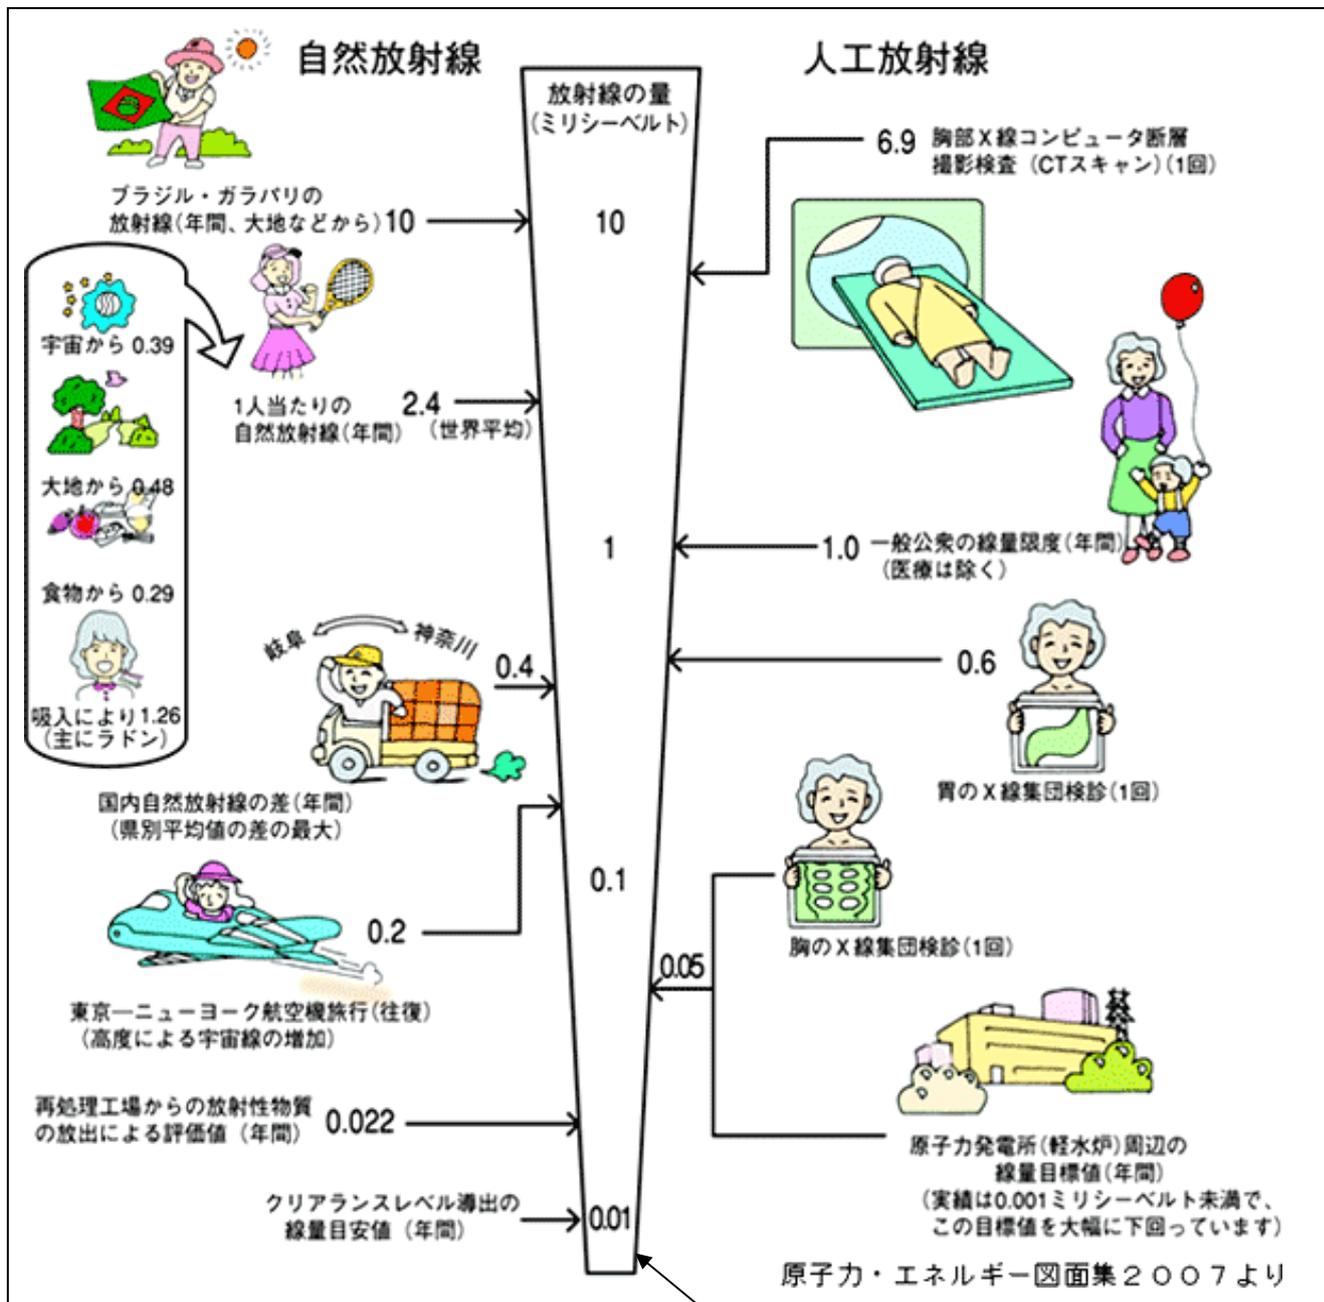

ポータブルX線装置による被ばく

1回の撮影で $1\mu\text{Sv}$ 程度、2m離れた場所は $0.15\mu\text{Sv}$ 以下です。

従って、撮影の際に被ばくを必要以上に恐れ病室から退出する必要はなく、1.5~2m離れば全く問題ありません。

当社では DCS-600EXV や DCS-900EX および LCT シリーズが該当